



# Konzentrationsmessung über die Prozesszeit – Betrieb der Oxidationsanlage

Messwerte vom 18.01.2017 Eingangskonzentration in mgC/m<sup>3</sup>

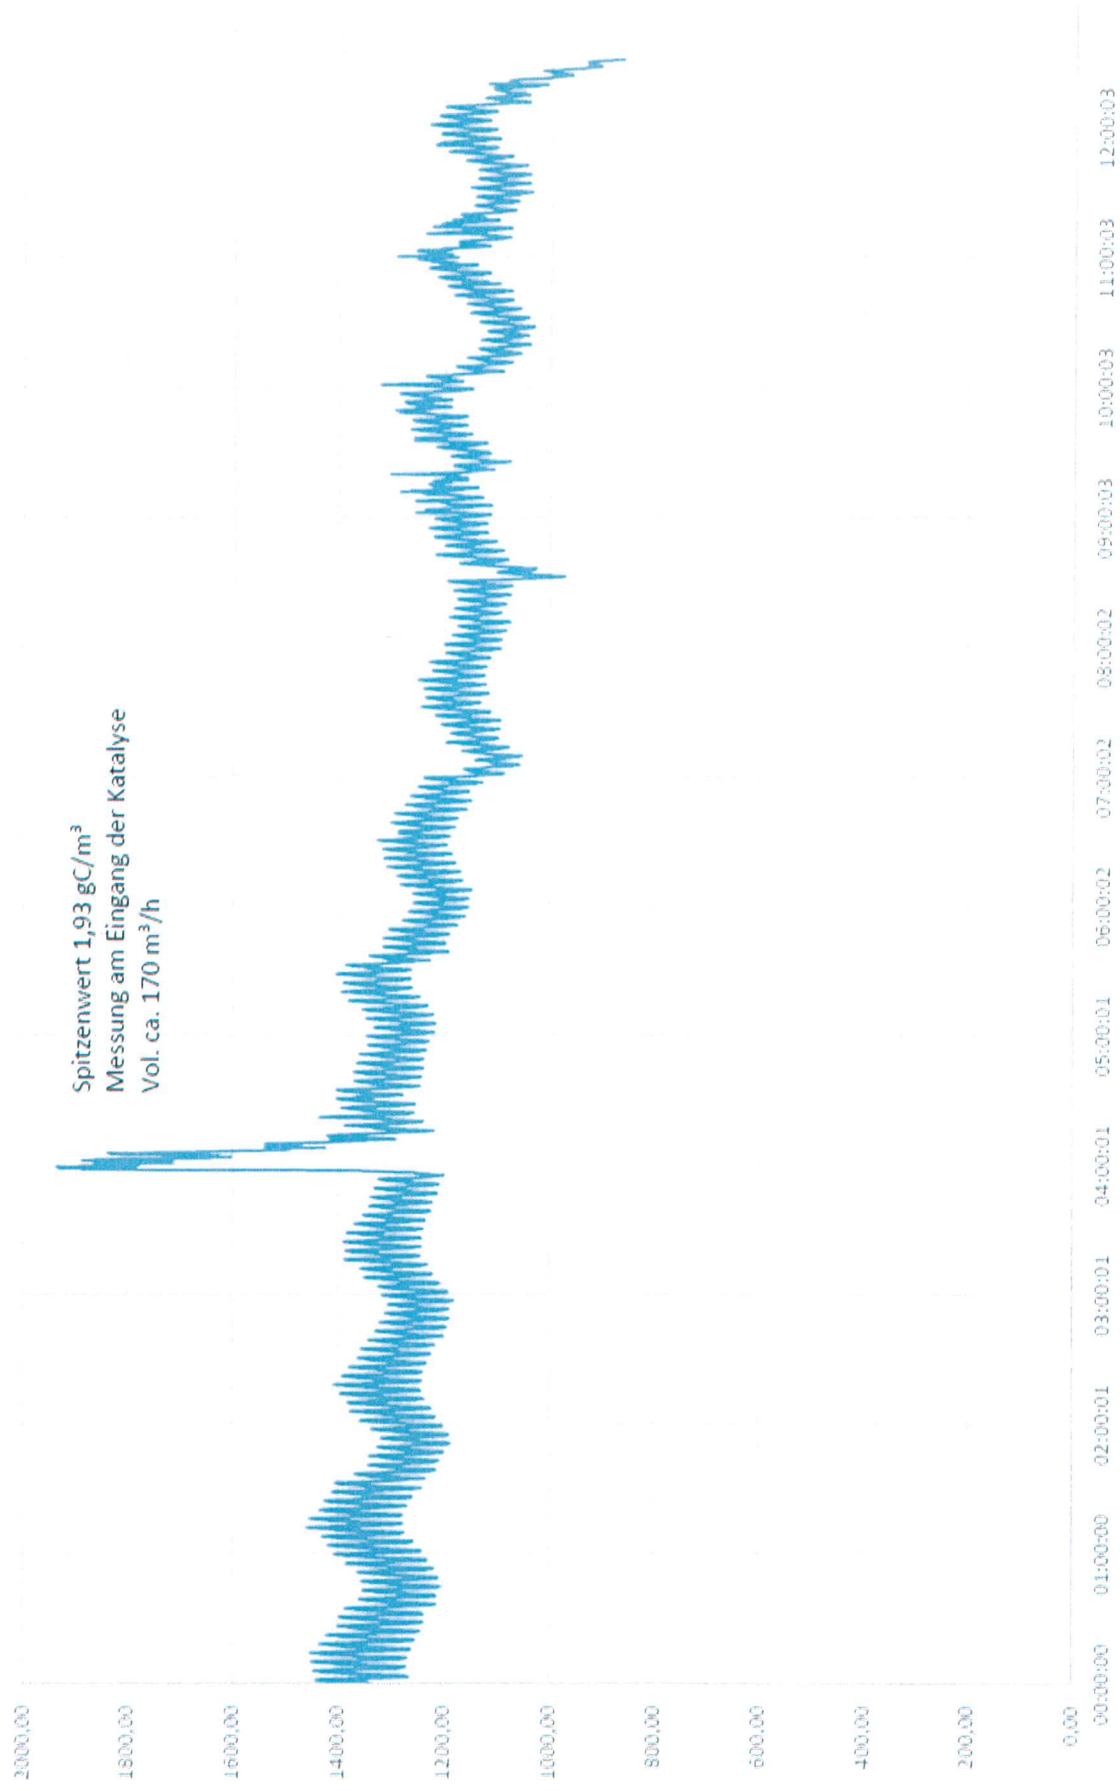

# Konzentrationsmessung über die Prozesszeit – Betrieb der Oxidationsanlage

Messwerte vom 17.01.2017 Eingangskonzentration in  $\text{mgC}/\text{m}^3$

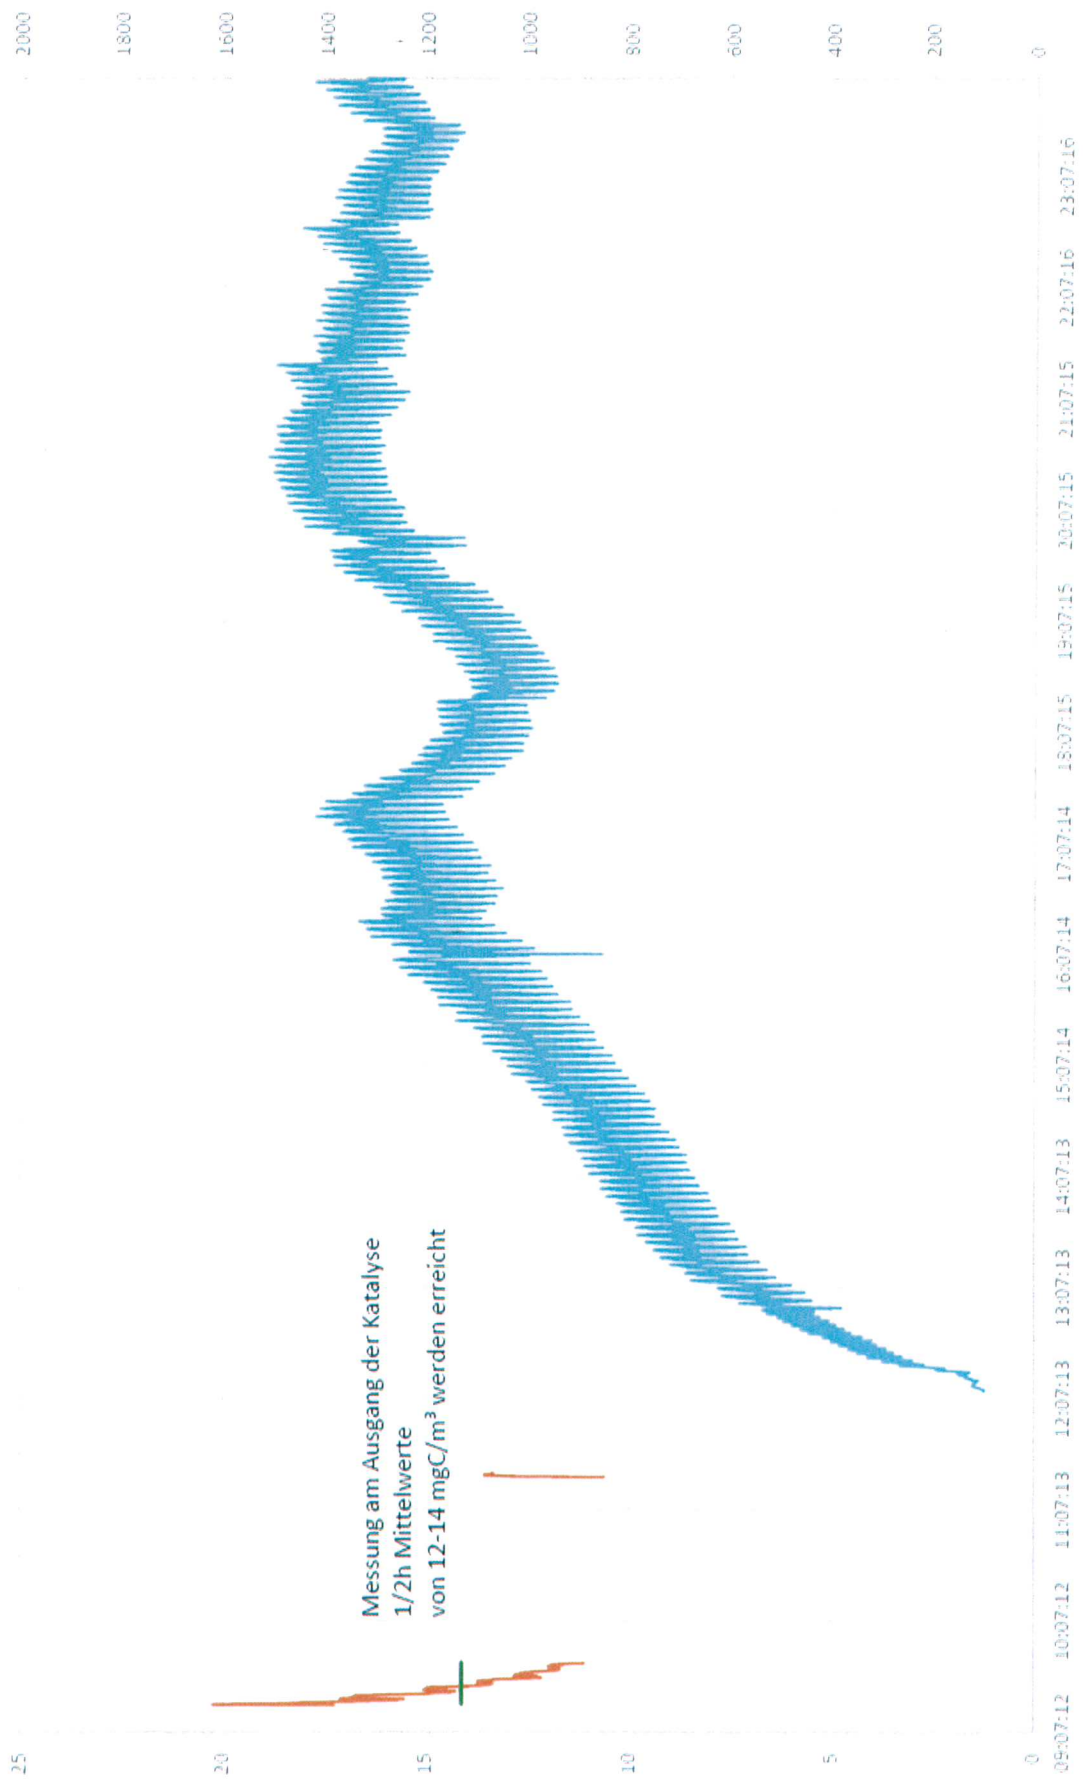

Messung am Ausgang der Katalyse  
1/2h Mittelwerte  
von 12-14  $\text{mgC}/\text{m}^3$  werden erreicht